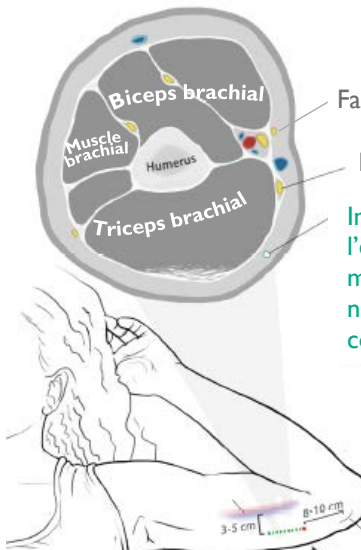


# Foire aux questions à propos de la mise à jour concernant le site d'insertion de Implanon NXT

#	Question	Réponse
1	<p>Quelles sont les nouvelles recommandations concernant l'insertion de l'implant Implanon NXT sous-cutané étonogestrel à un seul bâtonnet de Merck / Merck Sharp &amp; Dohme Corp. (MSD)?</p>	<p>L'implant sous-cutané d'étonogestrel à un seul bâtonnet, ou Implanon NXT, était auparavant inséré au niveau de la face interne du bras supérieur non dominant à environ 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médian de l'humérus) et en évitant le sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le sillon bicipital médial, où se situe le faisceau neurovasculaire).</p> <p>Les nouvelles directives recommandent de faire l'insertion au-dessus du triceps à environ 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médian de l'humérus) et de 3 à 5 cm (1,25-2 pouces) vers l'arrière du bras à partir du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. à l'arrière du sillon bicipital médial).</p>  <p><b>Implanon NXT doit être inséré sous l'épiderme (juste sous la peau et sur le muscle triceps, en évitant le faisceau neurovasculaire) pour un placement correct et retrait facile.</b></p>
2	<p>Quel est l'avantage d'insérer Implanon NXT au-dessus du triceps ?</p>	<p>Les résultats d'une étude de 2018 sur l'évaluation anatomique de la face interne du bras supérieur pour identifier les sites potentiels d'insertion d'Implanon NXT ont indiqué que l'insertion au-dessus du triceps, 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du coude (c.-à-d. proximal de l'épicondyle médial) et de 3 à 5 cm (1,25 à 2 pouces) vers l'arrière du bras à partir du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. postérieur au sillon bicipital médial) était une zone où les artères, les veines et les nerfs (c.-à-d. comme le faisceau neurovasculaire) ne sont généralement pas localisés. De plus, la flexion du coude déplace le nerf cubital (ulnaire), minimisant le risque de blessure dans les rares cas d'insertion profonde accidentelle.</p> <p>L'étude a conclu que l'insertion d'Implanon NXT à cet endroit minimise le risque de blessures aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux muscles et à d'autres tissus corporels associés à une insertion profonde incorrecte.</p> <p>Iwanaga J, Fox MC, Rekers H, Schwartz L, Tubbs RS. Neurovascular anatomy of the adult female medial arm in relationship to potential sites for insertion of the etonogestrel contraceptive implant. <i>Contraception</i>. 2019 Jul;100(1):26-30. doi: 10.1016/j.contraception.2019.02.007. Epub 2019 Mar 8</p>

#	Question	Réponse
3	<p>Les recommandations auraient-elles une incidence sur l'endroit où les implants sous cutanés à deux bâtonnets, comme Jadelle ou Sino-Implant (II)/Levoplant, sont insérés ?</p>	<p>Les recommandations relatives au nouveau site d'insertion s'appliquent uniquement à l'implant Implanon NXT.</p> <p>La méthode d'insertion et le positionnement des implants à 2 bâtonnets sous la peau (c.-à-d. sous-cutanée) sont considérées par le groupe d'experts comme sûres, efficaces et appropriées. La position angulaire en forme de « V » des implants et les directives existantes pour éviter les artères, les veines et les nerfs dans le sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le faisceau neurovasculaire dans le sillon bicipital médial) protège contre les blessures accidentelles généralement associées à une insertion profonde incorrecte. Les fabricants de <a href="#">Jadelle</a> et de <a href="#">Sino-Implant (II)/Levoplant</a> n'ont pas mis à jour leur guide d'insertion de manière similaire.</p> <p>Bayer. (2016). Jadelle (levonorgestrel implant): Highlights of prescribing information. Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd. (2017). Sino-Implant (II) (levonorgestrel implant): Summary of product characteristics.</p>
4	<p>Pour les utilisatrices qui veulent remplacer l'implant Implanon NXT et qui souhaitent continuer à l'utiliser, quelle est la recommandation ?</p>	<p>Les nouvelles directives recommandent que le nouvel implant Implanon NXT soit inséré dans le même bras et en utilisant la même incision que celle d'où l'implant précédent a été retiré, <b>tant que</b> le site est dans le nouvel emplacement, vers l'arrière du bras, au-dessus du triceps.</p> <p>Dans les cas où l'insertion précédente était dans l'ancien site d'insertion au-dessus du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le sillon bicipital médial), le prestataire devra faire l'insertion dans le nouveau site d'insertion.</p> <p>Il est essentiel d'informer la cliente sur le nouveau site d'insertion.</p>
5	<p>Que disent les organismes de réglementation au sujet des nouvelles directives sur l'insertion de l'implant Implanon NXT ?</p>	<p>Merck / MSD a obtenu l'approbation des organismes de réglementation de l'Union européenne, de la Food and Drug Administration des États-Unis et des agences de réglementation nationales concernant la mise à jour des informations cliniques sur le site d'insertion d'Implanon NXT.</p>
6	<p>Faut-il fournir les dernières mises à jour aux formateurs sur le nouveau site d'insertion ?</p>	<p>Les formateurs et mentors d'Implanon NXT formés et expérimentés devront recevoir des informations et des instructions appropriées détaillant le changement de pratique. Du matériel comprenant des outils de travail serait utile pour aider les prestataires. Les parties prenantes locales pourraient avoir intérêt à organiser un atelier pour planifier la dissémination et le mentorat.</p>

#	Question	Réponse
7	<p>Quel type de mises à jour pédagogiques sera nécessaire pour que les prestataires actuels adoptent le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion</p>	<p>La technique d'insertion d'Implanon NXT reste inchangée, à l'exception des étapes supplémentaires suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Positionner la main du bras dans lequel l'implant sera inséré (de préférence le bras non dominante) sous la tête et faire fléchir le coude suffisamment pour éloigner le nerf cubital (ulnaire) du site d'insertion ;</li> <li>2. Insérer à 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médial) et 3-5 cm (1,25-2 pouces) vers l'arrière du bras à partir du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. postérieur au sillon bicapital médial), au niveau du triceps.</li> </ol> <p>La technique d'insertion d'Implanon NXT n'a pas fait l'objet d'autres mises à jour.</p> <p>Les prestataires d'Implanon NXT formés et compétents devront recevoir des instructions détaillant le changement de pratique. Un outil de travail mis à jour sur l'insertion peut compléter les instructions. La nécessité d'une courte mise à jour pédagogique sur le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion devrait être évaluée par les parties prenantes locales et abordée en conséquence.</p>
8	<p>Les prestataires devraient-ils arrêter l'insertion de l'Implanon NXT jusqu'à ce qu'ils aient reçu des informations et / ou une orientation ?</p>	<p>La sécurité des clientes est primordiale. Il est également important de ne pas perturber la prestation des services de contraception, en particulier pour les clientes optant pour l'Implanon NXT. Les prestataires compétents qui sont convaincus de leur compétence à l'insertion de l'Implanon NXT peuvent continuer à fournir les services. Cependant, il est impératif que les nouvelles informations et les instructions appropriées soient disséminées largement et en temps opportun pour commencer à mettre en œuvre les nouvelles recommandations.</p>
9	<p>Quel est l'impact de ces nouvelles directives sur les formations des nouveaux prestataires de services Implanon NXT à l'avenir ?</p>	<p>A l'avenir, tous les prestataires de soins de santé formés aux services Implanon NXT devront être formés sur le nouveau site et à la nouvelle technique d'insertion. Cependant, ils doivent également être informés des directives préalables afin qu'ils puissent servir de manière appropriée les clientes qui ont reçu leur implant avant cette mise à jour et qui se présentent pour des soins de suivi.</p>
10	<p>Que devons-nous dire aux prestataires qui font le suivi des femmes qui utilisent Implanon NXT en ce qui concerne l'emplacement de l'implant ?</p>	<p>Il y aura une période de transition pendant laquelle les femmes qui ont eu une insertion dans l'ancien ou le nouveau site d'insertion feront un suivi auprès des prestataires. Pendant ce temps, il est essentiel que les prestataires demandent aux femmes où leur implant Implanon NXT a été inséré et où elles peuvent actuellement le sentir. Les prestataires doivent vérifier la position et, s'ils ne peuvent pas sentir l'implant, vérifier l'autre site d'insertion et, si nécessaire, l'autre bras avant de prendre en charge le cas comme un implant manquant ou profondément inséré.</p> <p>Ces informations doivent être diffusées à toute personne impliquée dans les soins de suivi afin de minimiser la possibilité de référer incorrectement des clientes pour des implants manquants.</p>

#	Question	Réponse
11	De quel matériel avons-nous besoin pour que les informations sur le nouveau site d'insertion d'Implanon NXT soient largement disseminées et mises en pratique ?	<p>Merck / MSD a disséminé des informations sur la technique et le site d'insertion mises à jour à tous les signataires de l'accord de coopération pour la réception et l'utilisation de l'Implanon NXT. Ces gouvernements, acheteurs et organisations sont chargés de veiller à ce que les prestataires de santé qui ont été formés ou qui seront formés à l'avenir soient informés de la mise à jour concernant le site et la technique d'insertion.</p> <p>Cette FAQ et les autres documents référencés dans ce paquet peuvent être utilisés par les signataires, les ministères de la santé, les groupes de travail techniques sur la planification familiale, les associations professionnelles, les institutions de formation et d'autres parties prenantes pour mettre à jour les formations et communiquer des détails supplémentaires sur ces mises à jour aux prestataires qui fournissent déjà des services d'implants Implanon NXT.</p>
12	Quel matériel est disponible pour appuyer le changement de pratique ?	<p>Les ressources de formation sur les implants Merck / MSD sont disponibles en plusieurs langues sur ce site : <a href="https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources">https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un jeu de diapositives expliquant le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion mise à jour pour former les prestataires de santé préalablement formés</li> <li>• Une vidéo montrant le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion de Merck / MSD pour former les prestataires de santé préalablement formés</li> <li>• Des diapositives de formation clinique, vidéos d'insertion et vidéos de retrait pour la formation de prestataires de santé non formés auparavant</li> </ul> <p>Ressources développées par les partenaires, en plusieurs langues, disponibles sur ce site : <a href="https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training">https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce document de questions fréquemment posées</li> <li>• Un document d'orientation avec des considérations pour la mise à jour des documents et des ressources de planification familiale</li> <li>• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion</li> <li>• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le retrait standard des implants insérés dans le nouveau site</li> <li>• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le retrait difficile des implants insérés dans le nouveau site »</li> </ul>
13	Si vous avez des questions supplémentaires qui ne figurent pas dans cette FAQ	Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter vos points focaux de PF2020. Des outils supplémentaires, du matériel de formation et d'autres ressources, ainsi que la traduction des documents ci-joints, seront également disponibles à l'avenir.

Ce document a été préparé par le groupe Implants Access Program (IAP) Operations Group. Ce groupe est composé de représentants de la Fondation Bill & Melinda Gates, du Fonds des Nations Unies pour la population, de l'Agence des États-Unis pour le développement international, de l'Organisation mondiale de la Santé et de Jhpiego. Pour toute question sur les conseils ou les ressources partagés, veuillez contacter

[implants.quality@jhpigo.org](mailto:implants.quality@jhpigo.org).